



Környezetegészségügyi előírások:

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 70°C-ot nem haladhatja meg.

Alkalmazási terület: MULTICAL® 21 és flowIQ® 2101 hideg/meleg vizes mérők ivó- és használati melegvíz ellátás flowIQ® 2200 hidegvizes mérő, ivóvíz ellátás.

A termék tisztítása, fertőtlenítése citromsav vizes oldatával való öblítéssel, pl. Cillit Bang, kosz- és vízkő eltávolító, Celin citromsavas vízköoldó. Mechanikai tisztítása puha, tiszta kefével lehetséges.

A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.


A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt vagy berendezést legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz vagy berendezés rendeltetésszerű használatát.

A termék beépítését követő néhány napban fém ill. szerves anyag kioldódásra lehet számítani, ami íz, szag és egyéb esztétikai problémát okozhat. Ez a jelenség átmeneti, a hálózat fokozott öblítésével, gyakoribb vízcsérével, átöblítéssel csökkenthető.


Comtech Kft. · 1221 Budapest · Jobbágy u. 5. · T: [1]226-1585 · F: [1]228-0544 · info@comtech-kft.hu · www.multical.hu



Ha rendelkezik okos telefonnal, letöltheti ezt a QR kódot és megnézheti a szerelési filmet online. A film elérhető a https://www.youtube.com/watch?v=_MeGjzA2qk-cmen címen is.

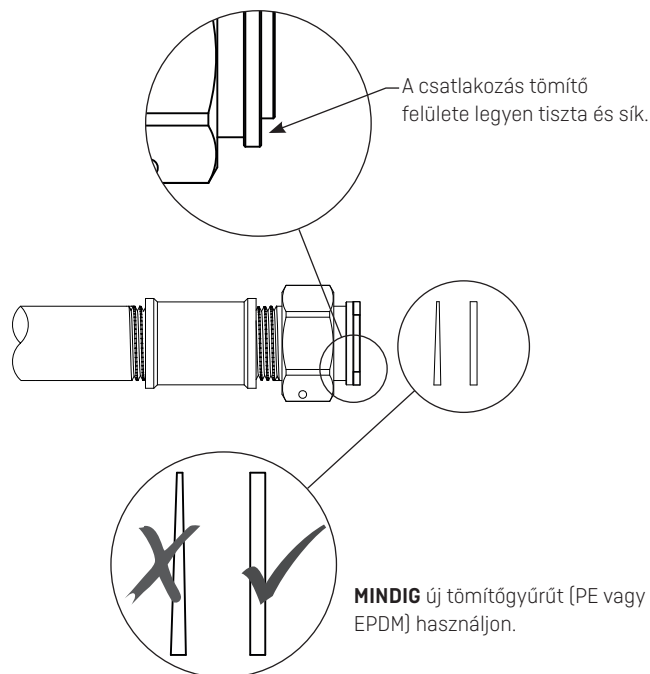


A csővezeték legyen párhuzamos, és illjen össze a mérővel.

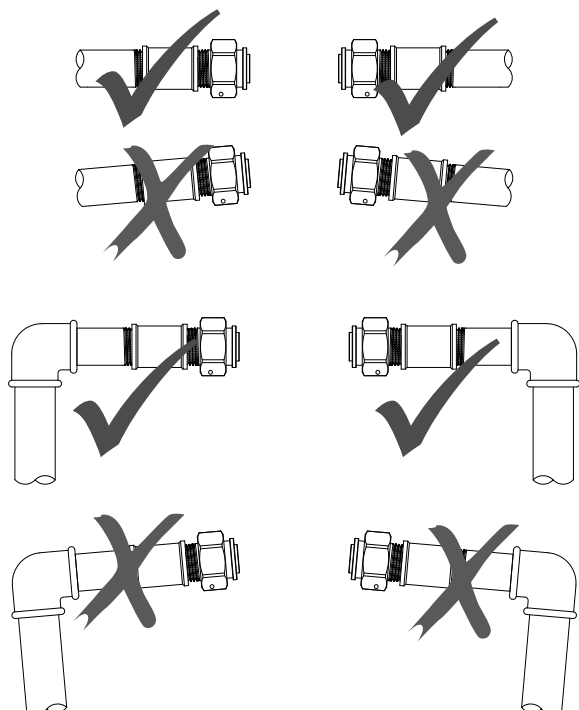

Nyomaték

Ha a vezeték ferdén szerelt annyira, hogy az előírt nyomatékokat túl kellene lépni, egy teleszkópius csatlakozót kell beiktatni.

¾"	Max. 15 Nm
1"	Max. 30 Nm

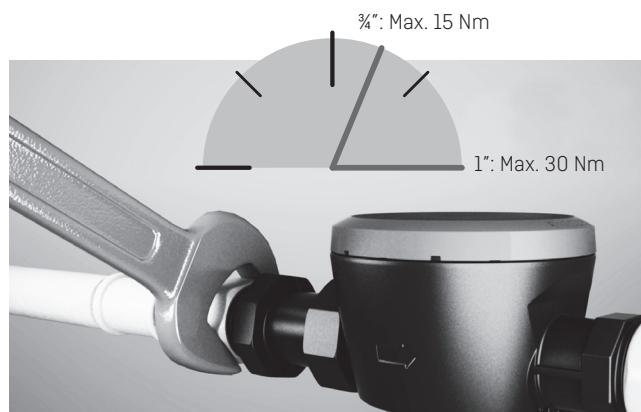

kamstrup

MULTICAL® 21 Szerelési útmutató

Kamstrup A/S · 5512921_01_HU_12.2020



